


**QUALITY CERTIFICATE**

Products Brand Name	condoms MAXUS - CLASSIC	Lubricant/Flavor	Silicone / None
Batch No.	L47241207	Color	Natural
Expiration Date	01.11.2029	Shape/Texture	Parallel / Smooth
Sample Quantity	1075 pcs	Sample Status	Comply
Inspections type	Sample Inspection	Testing Environments	Comply
		Testing Place	Company's lab
		Sample from	Company's warehouse
Test by Criterion	ISO 4074; ISO 2859-4; ISO 15223; WHO STANDARD		

Certificate of Analysis		Certificate of Analysis	Certificate of Analysis	Certificate of Analysis
Dimension	Length, mm	≥180	185.0	Comply
	Width, mm	53 ±2	53.8	Comply
	Thickness, mm	0,060-0.080	0.068	Comply
Blast Volume and Pressure	Burst Pressure, kPa (Untreated)	≥20.0	~ 22	Comply
	Burst Pressure, kPa (Oven treated 168±2 hours, 70±2 °C)	≥17.0	~ 18	Comply
Pin Hole	Put 300 cm <sup>3</sup> ±10 cm <sup>3</sup> water, no leakage	Comply	Comply	
Lubricant quantity, mg/pcs	400-700	516	Comply	
Outside package integrity	Vacuumed at (20±5) kPa Absolute Pressure 1 min, no continuing bubble, no leakage in the individual pack	Comply	Comply	
Visual Defects	No breakage, lack or mistake	Comply	Comply	
Labeling	Used symbols from ISO 15223	Comply	Comply	
Test Conclusion	Tested products applying to ISO 4074:2015 «Natural Rubber Latex Male Condoms - Requirements and Testing Methods», ISO 2859-4:2020 «Sampling procedures for inspection by attributes – Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels». We take the responsibility if occurs something wrong.			
Remark	Tested sample comply with ISO 4074; ISO 2859-4; ISO 15223; WHO STANDARD			

Approved by Quality Department PharmLine s.r.o.

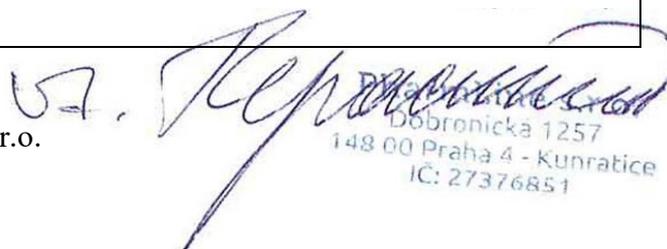

PharmLine s.r.o.  
 Dobronická 1257  
 148 00 Praha 4 - Kunratice  
 IČ: 27376851

## Паспорт качества

Products Brand Name	презервативы MAXUS - CLASSIC	Смазка / Аромат	Силикон / отсутствует
Партия №	L47241207	Цвет	Натуральный
Срок годности	01.11.2029	Форма / Текстура	Параллельная / гладкая
Количество образцов	1075 штук	Состояние образцов	Соответствуют требованиям
Вид испытаний	Проверка образцов	Условия испытаний	Соответствуют требованиям
		Место испытаний	Лаборатория компании
		Место хранения образцов	Склад компании
Проверка на соответствие		ISO 4074; ISO 2859-4; ISO 15223; Стандарт ВОЗ	

Показатели испытаний		Технические требования	Результат испытаний	Заключение
Размерные показатели	Длина, мм	≥180	185.0	Соответствуют
	Ширина, мм	53 ±2	53.8	Соответствуют
	Толщина, мм	0,060-0.080	0.068	Соответствуют
Объем и Давление разрыва	Давление разрыва, кПа (необработанный)	≥20.0	~ 22	Соответствуют
	Давление разрыва, кПа (Обработанный в духовке 168±2 часа, 70±2°C)	≥17.0	~ 18	Соответствуют
Точечные отверстия		При наполнении 300 см <sup>3</sup> ±10 см <sup>3</sup> воды, не должно быть утечки	Соответствуют	Соответствуют
Количество лубриканта, мг/шт.		400-700	516	Соответствуют
Целостность внешней упаковки		Вакуумируется при давлении (20±5) кПа Абсолютное давление 1 мин, пузырьки не образуются, утечка в индивидуальной упаковке отсутствует	Соответствуют	Соответствуют
Визуальные дефекты		Отсутствуют поломки, недостатки или ошибки	Соответствуют	Соответствуют
Маркировка		Используются символы из ISO 15223	Соответствуют	Соответствуют
Результат тестирования:	Протестированные продукты соответствуют требованиям стандартов ISO 4074 «Мужские презервативы из натурального латекса - требования и методы тестирования», ISO 2859-4 «Процедуры отбора проб для проверки по признакам – Часть 4: Процедуры оценки заявленных уровней качества». Мы берем на себя ответственность, если происходит что-то не так.			
Примечание	Испытанные образцы соответствуют ISO 4074; ISO 2859-4; ISO 15223; Стандарт ВОЗ			

Утверждено Отделом качества Фармлайн ООО